

UREĐAJI ZA PRIPREMU I ISPITIVANJE VISOKOTLAČNIH CIJEVI

UREĐAJ	PROIZVOĐAČ	TIP	BROJ OKRETAJA
--------	------------	-----	---------------

REZALICA	KO-FLEX	R 1	2800 okr/min
----------	---------	-----	--------------

- Elektromotor 3 kW / 3 x 380 V sa kućištem i alatom
- Primjena: niskotlačne cijevi:

No	50
3TE, 1SN, 2SN:	NP 50
4SP, 4SH, 35X (okretanjem):	NP 50
42X (okretanjem):	NP 38
- Rezervni alat (reznna ploča Ø 230 mm)




LJUŠTILICA	KO-FLEX	LJ 1	58 okr/min
------------	---------	------	------------

- Motoreduktor 1,2 kW / 3x380 V bez alata, ali sa kućištem



- Alat za vanjsko ljuštenje (po NP)



- Alat za unutarnje ljuštenje (po NP)




Kod naručivanja kompleta od 8 alata za vanjsko ljuštenje (NP 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38 i 50) i 5 alata za unutarnje ljuštenje (NP 19, 25, 32, 38 i 50) odobrava se rabat od 10%, tako da ukupna cijena za njih iznosi 2232,00 kn.

REZALICA / LJUŠTILICA**MANULI****M30 CUT & SKIVE****3000 / 60 okr/min**

- Motoreduktor 3 kW / 3 x 380 V sa kućištem i alatom za rezanje, ali bez alata za ljuštenje
- Primjena: niskotlačne cijevi:


NO	75
3TE, 1SN, 2SN:	NP 50
4SP, 4SH, 35X (okretanjem):	NP 50
42X	NP 32

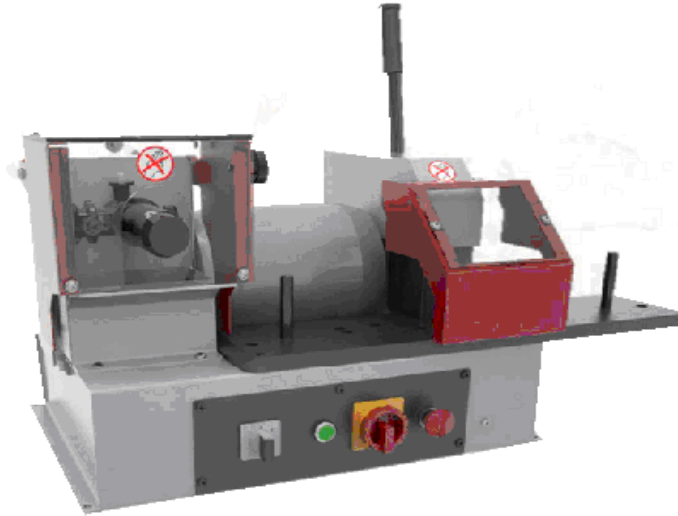

- Komplet alata za vanjsko ljuštenje (NP 6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38 i 50)



- Komplet alata za unutarnje ljuštenje (NP 13, 16, 19, 25, 32, 38 i 50)

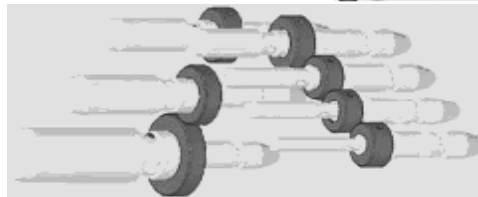**ISPITNI STOL****MANULI****MTB1500**

-

- Primjena: 3TE, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, 35X, 42X
- Max. ispitni tlak: 1500 bara
- Max. broj istovremeno ispitanih cijevi: 5
- Ispitni fluid: voda

